Fiche technique
EasyCare

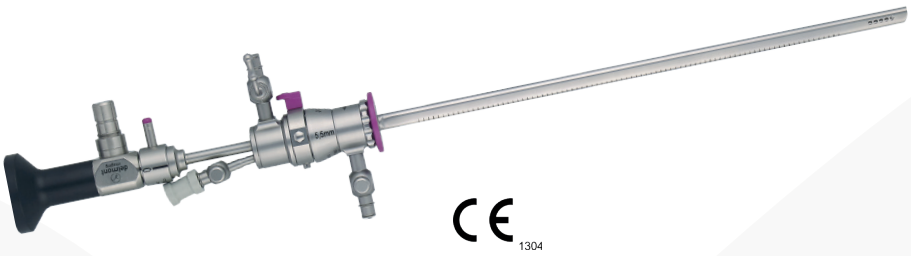

Le set complet EasyCare comporte :
- 1 hystéroscope HD
- 1 chemise opératoire externe graduée
- 1 chemise opératoire interne graduée
- 1 chemise diagnostique graduée
- 4 instruments
- 1 câble de lumière

Set instruments avec canal de nettoyage
Ref : D400 100 017
Code GTIN/UID-ID : 3701217802896

Set instruments sans canal de nettoyage
Ref : D400 100 000
Code GTIN/UID-ID : 3701217802612

Informations générales	
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	*Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails*
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Hystéroscope	
Réglementation	
Descriptif	Hystéroscope HD 2,9 mm 30°
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement
Photo	
Classe	IIa
Référence article	D300 100 000
Code GMDN	36628
Code GTIN/UID ID	3701217800168
Données techniques	
Résolution	HD

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 039 D FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Diamètre de l'hystéroscope	2,9 mm
Angulation (DOV)	30°
Type de technologie	Lentilles
Longueur utile	300 mm
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Raccordement pour câble de lumière	Type ACMI
Adaptateur pour câble de lumière	Type Wolf, Storz, Olympus
Système d'hystéroscopie	
Réglementation	
Descriptif	Chemises d'hystéroscopie diagnostique et interventionnelle
Utilisation prévue	Hystéroscopie
Photos	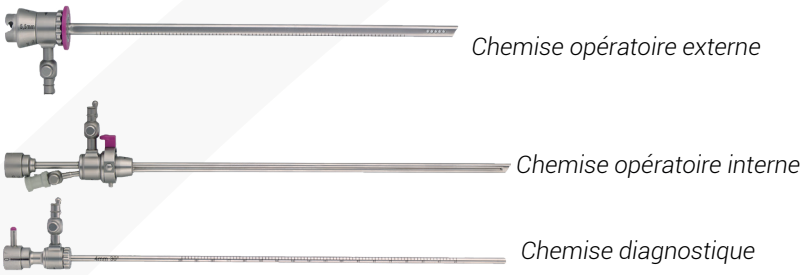
Classe	IIa
Code GMDN	37086
Chemise opératoire externe graduée	
Référence article	D300 110 000
Code GTIN/UID ID	3701217800618
Diamètre de la chemise externe	5,5 mm
Longueur utile	216 mm
Robinet d'aspiration rotatif	Oui
Encliquetage rapide	Oui
Graduation	Oui
Chemise externe atraumatique	Oui
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Chemise opératoire interne graduée	
Référence article	D300 110 001
Code GTIN/UID ID	3701217800625
Diamètre de la chemise interne	4,9 mm
Longueur utile	230 mm
Diamètre du canal opératoire	7Fr.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 039 D FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Robinet d'irrigation rotatif	Oui	
Longueur du canal d'insertion du canal opératoire	Long	
Graduation	Oui	
Chemise interne atraumatique	Oui	
Chemises internes et externes dissociables	Oui	
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	
Chemise diagnostique graduée		
Référence article	D300 110 002	
Code GTIN/UID ID	3701217800632	
Diamètre de la chemise diagnostique	4 mm	
Longueur utile	270 mm	
Robinet d'irrigation rotatif	Oui	
Graduation	Oui	
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	
Instruments		
Réglementation		
Descriptif	Instruments chirurgicaux réutilisables : ciseaux et pinces	
Utilisation prévue	Chirurgie endoscopique	
Photos	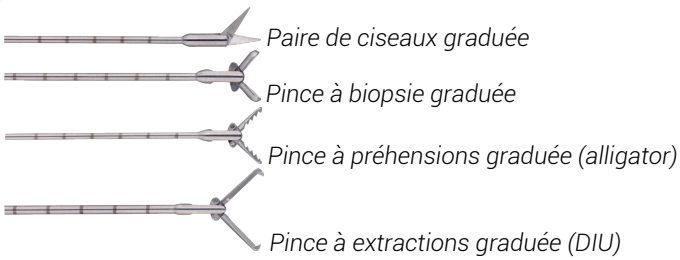	
Classe	I	
Paire de ciseaux graduée		
Référence article	D300 120 008	D300 120 000
Code GTIN/UID ID	3701217802858	3701217801196
Luer-Lock pour canal de nettoyage	Oui	Non
Souplesse	Semi-rigide	
Diamètre	7Fr.	
Longueur utile	340 mm	
Mors mobiles	1	
Graduation	Oui	
Module de rotation	Non	

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 039 D FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	
Pince à biopsie graduée		
Référence article	D300 120 010	D300 120 002
Code GTIN/UID ID	3701217802872	3701217801219
Luer-Lock pour canal de nettoyage	Oui	Non
Souplesse	Semi-rigide	
Diamètre	7Fr.	
Longueur utile	340 mm	
Mors mobiles	2	
Graduation	Oui	
Module de rotation	Non	
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	
Pince à préhensions graduée		
Référence article	D300 120 009	D300 120 001
Code GTIN/UID ID	3701217802865	3701217801202
Luer-Lock pour canal de nettoyage	Oui	Non
Souplesse	Semi-rigide	
Diamètre	7Fr.	
Longueur utile	340 mm	
Mors mobiles	2	
Graduation	Oui	
Module de rotation	Non	
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	
Pince à extractions graduée		
Référence article	D300 120 011	D300 120 003
Code GTIN/UID ID	3701217802889	3701217801226
Luer-Lock pour canal de nettoyage	Oui	Non
Souplesse	Semi-rigide	
Diamètre	7Fr.	
Longueur utile	340mm	
Mors mobiles	2	
Graduation	Oui	
Module de rotation	Non	
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 039 D FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Câble de lumière	
Réglementation	
Descriptif	Câble de lumière
Utilisation prévue	Endoscopie
Photo	
Classe	I
Référence article	D200 150 500
Code GMDN	35507
Code GTIN/UID ID	3701217800090
Données techniques	
Diamètre	3,5 mm
Longueur	2,3 m
Couleur	Gris
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Embouts fournis	Storz

Document non contractuel - Ref D900 700 039 D FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Retraitement

Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails.

Nettoyage et désinfection automatisés

Pré-nettoyage	❶ S'il y a lieu : démonter les dispositifs autant que possible. Immergez les dispositifs dans l'eau froide du robinet pendant au moins 5 minutes. ❷ Brossez les dispositifs sous l'eau froide jusqu'à ce que tous les résidus visibles aient été éliminés. Les canaux intérieurs, les fils et les trous doivent être rincés avec un pistolet à jet d'eau pendant au moins 10 secondes en mode pulsé. ❸ Immergez les dispositifs hors électrodes et endoscopes dans un bain ultrasonique alcalin (0,5%) et traitez aux ultrasons pendant 15 minutes à 40°C. Solution utilisée: Neodisher Mediclean forte, Dr. Weigert, Hambourg. ❹ Sortez le dispositif du bain et rincez-le à l'eau froide du robinet.
Nettoyage automatisé	❶ Placez les dispositifs dans un panier sur le module d'insertion et commencez le processus de nettoyage. Machine utilisée : Miele G 7736 CD, module insérable Miele E 327-06, module CMI Miele E 450 ❷ Prérincer pendant 1 min. avec de l'eau froide. Drainage. ❸ Prérincer pendant 3 min. avec de l'eau froide. Drainage. ❹ Laver pendant 5 min. à 55°C avec une solution alkaline à 0,5%. Solution utilisée: Neodisher Mediclean forte; Dr. Weigert; Hamburg. ❺ Drainage. ❻ Neutraliser pendant 3 minutes avec de l'eau chaude du robinet (>40°C) et un agent neutralisant. Solution utilisée : Neodisher Z; Dr. Weigert. Drainage. ❼ Rincer à l'eau tiède (>40°C) pendant 2 minutes.
Désinfection	❶ Désinfection thermique automatisée pendant 95s. à 95°C
	Conformément à la norme ISO 15883 et en tenant compte des exigences nationales pour la valeur AO.
Séchage	Sécher l'extérieur des instruments en effectuant un cycle de séchage de la machine de nettoyage/désinfection. Si nécessaire, le séchage manuel peut également être effectué à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Sécher les cavités en soufflant avec de l'air comprimé stérile

Stérilisation

Vide fractionné	Température	Temps	Séchage
3 phases avec une pression d'au moins 60 millibars	134°C	Au moins 4 min.	Au moins 10 min.

Conformément aux normes ISO 13060, ISO 17665 et en tenant compte des exigences nationales respectives.

Environnement

Condition	Température	Humidité	Pression
Transport (non stérile)	-10°C à +40°C	10 à 90%	800 à 1060 hPa
Stockage (non stérile)	- 10°C à +40°C	10 à 90%	800 à 1060 hPa
Utilisation	+10°C à + 40 °C	30 à 75%	800 à 1060 hPa

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 039 D FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.