Fiche technique
ReseCare

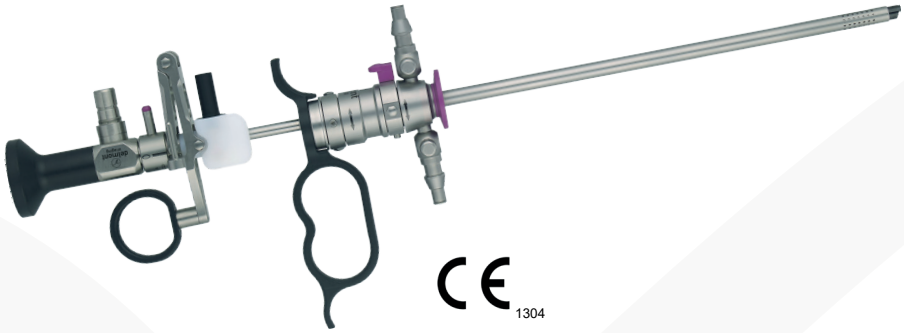

Le set complet ReseCare comporte :
- 1 hystéroscope HD
- 1 chemise externe
- 1 chemise interne
- 1 élément de travail
- 4 électrodes HF
- 1 câble de lumière

Set Passif
Ref : D400 100 011
Code GTIN/UID ID : 3701217802674

Set Actif
Ref : D400 100 013
Code GTIN/UID ID : 3701217804111

Informations générales	
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	*Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails*
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Hystéroscope	
Réglementation	
Descriptif	Hystéroscope HD 2,9 mm 12°
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement
Photo	
Classe	IIa
Référence article	D300 100 004
Code GMDN	36628
Code GTIN/UID	3701217802599
Données techniques	
Résolution	HD

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel- Ref D900 700 040 C FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Diamètre de l'hystéroscope	2,9 mm
Angulation (DOV)	12°
Type de technologie	Lentilles
Longueur utile	300 mm
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Raccordement pour câble de lumière	Type ACMI
Adaptateur pour câble de lumière	Type Wolf, Storz, Olympus
Système de résection	
Réglementation	
Descriptif	Ensemble composé d'éléments de travail et chemises de résection
Utilisation prévue	Résection bipolaire ou monopolaire
Photos	*Chemise externe* *Chemise interne* *Element de travail passif* *Element de travail actif*
Classe	IIb
Chemise externe	
Référence article	D300 130 000
Code GMDN	37806
Code GTIN/UID ID	3701217801271
Diamètre de la chemise externe	18,5Fr.
Longueur utile	187 mm
Encliquetage rapide	Oui
Flux	Double
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel- Ref D900 700 040 C FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Chemise interne		
Référence article	D300 130 001	
Code GMDN	37806	
Code GTIN/UID ID	3701217801288	
Diamètre de la chemise interne	17,5Fr.	
Isolation	Céramique noire (4.5 mm)	
Chemise rotative	Oui	
Chemises internes et externes dissociables	Oui	
Encliquetage rapide	Oui	
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	
Element de travail		
Action	Passive	Active
Référence article	D300 130 002	D300 130 009
Code GMDN	37805	
Code GTIN/UID ID	3701217801295	3701217801363
Compatible avec énergies bipolaires	Oui	
Compatible avec énergies monopolaires	Oui	
Quick-lock entre les deux chemises et l'élément de travail	Oui	
Electrodes HF		
Réglementation		
Descriptif	Electrodes HF pour système de résection	
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement. Ablation, coupe, coagulation de tissus	
Photo	*Electrode coupante 30°* *Electrode coupante droite* *Electrode rouleau* *Electrode couteau*	
Classe	IIb	

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel- Ref D900 700 040 C FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Electrodes à usage unique				
Nom	Electrode coupante 30°	Electrode coupante droite	Electrode couteau	Electrode rouleau
Référence article	D300 140 067	D300 140 068	D300 140 069	D300 140 070
Code GMDN	61872			
Code GTIN/UID ID	3701217802766	3701217802773	3701217802780	3701217802797
Packaging	10 par boîte			
Autoclavable	Non, déjà stérile et à usage unique			
Méthode de stérilisation	ETO			
Electrodes réutilisables				
Nom	Electrode coupante 30°	Electrode coupante droite	Electrode couteau	Electrode rouleau
Référence article	D300 140 000	D300 140 001	D300 140 002	D300 140 003
Code GMDN	61873			
Code GTIN/UID ID	3701217802131	3701217802148	3701217802155	3701217802162
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*			
Données techniques				
Code couleur	Violet			
Compatibilité	Résecteur 18,5Fr.			
Puissance de sortie du générateur	max. 2 kVp			
Puissance recommandée mode de coupe	120-180 W			
Puissance recommandée mode de coagulation	max. 100 W			
Solution à utiliser en monopolaire	Glycine ou Purisole par exemple			
Solution à utiliser en bipolaire	NaCl à 0.9%			
Câble de lumière				
Réglementation				
Descriptif	Câble de lumière			
Utilisation prévue	Endoscopie			
Photo				

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel- Ref D900 700 040 C FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Classe	I
Référence article	D200 150 500
Code GMDN	35507
Code GTIN/UID ID	3701217800090
Données techniques	
Diamètre	3,5 mm
Longueur	2,3 m
Couleur	Gris
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Embouts fournis	Storz

Document non contractuel- Ref D900 700 040 C FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

delmont imaging

Retraitement

Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails.

Nettoyage et désinfection automatisés

Pré-nettoyage	❶ S'il y a lieu : démonter les dispositifs autant que possible. Immergez les dispositifs dans l'eau froide du robinet pendant au moins 5 minutes. ❷ Brossez les dispositifs sous l'eau froide jusqu'à ce que tous les résidus visibles aient été éliminés. Les canaux intérieurs, les fils et les trous doivent être rincés avec un pistolet à jet d'eau pendant au moins 10 secondes en mode pulsé. ❸ Sortez le dispositif du bain et rincez-le à l'eau froide du robinet.
Nettoyage automatisé	❶ Placez les dispositifs dans un panier sur le module d'insertion et commencez le processus de nettoyage. Machine utilisée : Niagara SI PCF – Medisafe ❷ Prérincer avec activation pulsée d'un nettoyage ultrasonique pendant 3 min., 25°C. ❸ Drainage. ❹ Laver avec activation pulsée d'un nettoyage ultrasonique pendant 20 min. à 40°C avec une solution enzymatique à 0,35%. Solution utilisée: M20029 3E-Zyme Scope Plus, Medisafe. ❺ Drainage. ❻ Rincez à l'eau déminéralisée, 2min, 25°C. Drainage. ❼ Rincez à l'eau déminéralisée, 1min, 25°C.
Désinfection	❶ Désinfection thermique automatisée pendant 95s. à 95°C
	Conformément à la norme ISO 15883 et en tenant compte des exigences nationales pour la valeur A0.
Séchage	Sécher l'extérieur des instruments en effectuant un cycle de séchage de la machine de nettoyage/désinfection. Si nécessaire, le séchage manuel peut également être effectué à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Sécher les cavités en soufflant avec de l'air comprimé stérile

Stérilisation

Vide fractionné	Température	Temps	Séchage
3 phases avec une pression d'au moins 60 millibars	134°C	Au moins 4 min.	Au moins 10 min.

Conformément aux normes ISO 13060, ISO 17665 et en tenant compte des exigences nationales respectives.

Environnement

Condition	Température	Humidité	Pression
Transport (non stérile)	-10°C à +40°C	10 à 90%	800 à 1060 hPa
Stockage (non stérile)	- 10°C à +40°C	10 à 90%	800 à 1060 hPa
Utilisation	+10°C à + 40 °C	30 à 75%	800 à 1060 hPa

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel- Ref D900 700 040 C FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.