Fiche technique
MaxiCare

Le set complet MaxiCare comporte :
- 1 hystéroscope HD
- 1 chemise externe
- 1 chemise interne
- 1 élément de travail
- 5 électrodes HF
- 1 câble de lumière

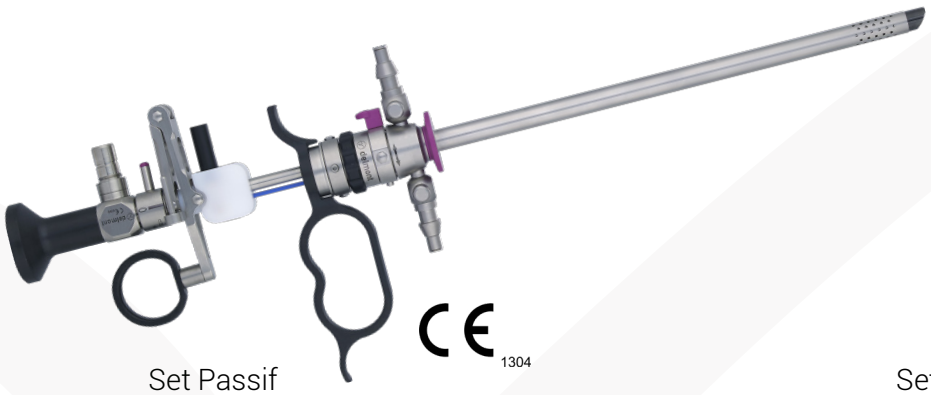

Set Passif
Ref : D400 100 008
Code GTIN/UID-ID : 3701217802667

Set Actif
Ref : D400 100 004
Code GTIN/UID-ID : 3701217802650

Informations générales	
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	*Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails*
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Hystéroscope	
Réglementation	
Descriptif	Hystéroscope HD 4 mm 12°
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique et urologique uniquement
Photo	
Classe	IIa
Référence article	D300 100 002
Code GMDN	36628
Code GTIN/UID ID	3701217800182

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 045 B FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Données techniques	
Résolution	HD
Diamètre de l'hystéroscope	4 mm
Angulation (DOV)	12°
Type de technologie	Lentilles
Longueur utile	300 mm
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Raccordement pour câble de lumière	Type ACMI
Adaptateur pour câble de lumière	Type Wolf, Storz, Olympus
Système de résection	
Réglementation	
Descriptif	Ensemble composé d'éléments de travail et chemises de résection
Utilisation prévue	Résection bipolaire pour gynécologie et urologie uniquement
Photos	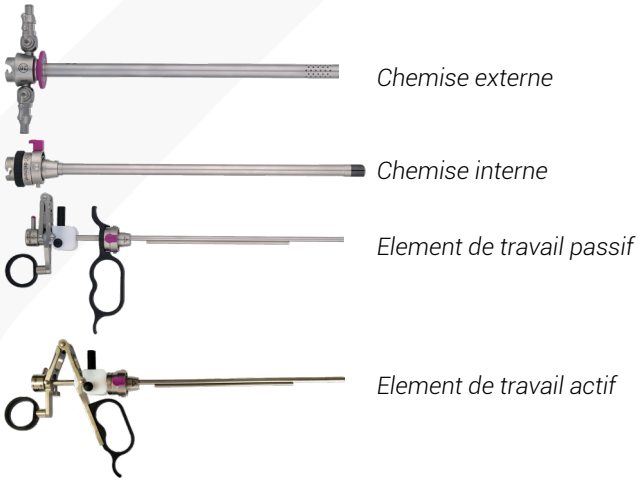 *Chemise externe* *Chemise interne* *Element de travail passif* *Element de travail actif*
Classe	IIb
Chemise externe	
Référence article	D300 130 004
Code GMDN	37806
Code GTIN/UID ID	3701217801318
Diamètre de la chemise externe	26Fr.
Longueur utile	187 mm
Encliquetage rapide	Oui

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 045 B FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Flux	Double	
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	
Chemise interne		
Référence article	D300 130 005	
Code GMDN	37806	
Code GTIN/UID ID	3701217801325	
Diamètre de la chemise interne	24Fr.	
Isolation	Céramique noire (4.5 mm)	
Chemise rotative	Oui	
Chemises internes et externes dissociables	Oui	
Encliquetage rapide	Oui	
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*	
Elément de travail		
Action	Passive	Active
Référence article	D300 130 006	D300 130 008
Code GMDN	37805	
Code GTIN/UID ID	3701217801332	3701217801356
Compatible avec énergies bipolaires	Oui	
Compatible avec énergies monopolaires	Non	
Quick-lock entre les deux chemises et l'élément de travail	Oui	
Electrodes HF		
Réglementation		
Descriptif	Electrodes HF pour système de résection	
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique et urologique uniquement. Ablation, coupe, coagulation de tissus	
Photos	*Electrode coupante 30°* *Electrode coupante droite* *Electrode rouleau* *Electrode couteau* *Electrode de vaporisation rouleau à pointe*	

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 045 B FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Classe	IIb				
Electrodes à usage unique					
Nom	Electrode coupante 30°	Electrode coupante droite	Electrode rouleau	Electrode couteau	Electrode de vaporisation rouleau à pointe
Référence article	D300 140 078	D300 140 081	D300 140 080	D300 140 079	D300 140 082
Code GMDN	61872				
Code GTIN/UID ID	3701217802940	3701217802971	3701217802964	3701217802957	3701217802988
Packaging	10 par boîte				
Autoclavable	Non, déjà stérile et à usage unique				
Méthode de stérilisation	ETO				
Electrodes réutilisables					
Nom	Electrode coupante 30°	Electrode coupante droite	Electrode rouleau	Electrode couteau	Electrode de vaporisation rouleau à pointe
Référence article	D300 140 004	D300 140 007	D300 140 006	D300 140 005	D300 140 008
Code GMDN	61873				
Code GTIN/UID ID	3701217802179	3701217802209	3701217802193	3701217802186	3701217802216
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*				
Données techniques					
Code couleur	Violet				
Compatibilité	Résecteur 26Fr.				
Puissance de sortie du générateur	max. 2 kVp				
Puissance recommandée mode de coupe	120-180 W				
Puissance recommandée mode de coagulation	max. 100 W				
Solution à utiliser en bipolaire	NaCl à 0.9%				
Câble de lumière					
Réglementation					
Descriptif	Câble de lumière				
Utilisation prévue	Endoscopie				

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 045 B FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

Photo	
Classe	I
Référence article	D200 150 500
GMDN	35507
Code GTIN/UID ID	3701217800090
Données techniques	
Diamètre	3,5 mm
Longueur	2,3 m
Couleur	Gris
Autoclavable	Oui. *Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails*
Embouts fournis	Storz

Document non contractuel - Ref D900 700 045 B FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

delmont imaging

Retraitement

Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails.

Nettoyage et désinfection automatisés

Pré-nettoyage	❶ S'il y a lieu : démonter les dispositifs autant que possible. Immergez les dispositifs dans l'eau froide du robinet pendant au moins 5 minutes. ❷ Brossez les dispositifs sous l'eau froide jusqu'à ce que tous les résidus visibles aient été éliminés. Les canaux intérieurs, les fils et les trous doivent être rincés avec un pistolet à jet d'eau pendant au moins 10 secondes en mode pulsé. ❸ Sortez le dispositif du bain et rincez-le à l'eau froide du robinet.
Nettoyage automatisé	❶ Placez les dispositifs dans un panier sur le module d'insertion et commencez le processus de nettoyage. Machine utilisée : Niagara SI PCF – Medisafe ❷ Prérincer avec activation pulsée d'un nettoyage ultrasonique pendant 3 min., 25°C. ❸ Drainage. ❹ Laver avec activation pulsée d'un nettoyage ultrasonique pendant 20 min. à 40°C avec une solution enzymatique à 0,35%. Solution utilisée: M20029 3E-Zyme Scope Plus, Medisafe. ❺ Drainage. ❻ Rincez à l'eau déminéralisée, 2min, 25°C. Drainage. ❼ Rincez à l'eau déminéralisée, 1min, 25°C.
Désinfection	❶ Désinfection thermique automatisée pendant 95s. à 95°C
	Conformément à la norme ISO 15883 et en tenant compte des exigences nationales pour la valeur AO.
Séchage	Sécher l'extérieur des instruments en effectuant un cycle de séchage de la machine de nettoyage/désinfection. Si nécessaire, le séchage manuel peut également être effectué à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Sécher les cavités en soufflant avec de l'air comprimé stérile

Stérilisation

Vide fractionné	Température	Temps	Séchage
3 phases avec une pression d'au moins 60 millibars	134°C	Au moins 4 min.	Au moins 10 min.
Conformément aux normes ISO 13060, ISO 17665 et en tenant compte des exigences nationales respectives.			

Environnement

Condition	Température	Humidité	Pression
Transport (non stérile)	-10°C à +40°C	10 à 90%	800 à 1060 hPa
Stockage (non stérile)	- 10°C à +40°C	10 à 90%	800 à 1060 hPa
Utilisation	+10°C à + 40 °C	30 à 75%	800 à 1060 hPa

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 045 B FR - 2020-05 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.