Quick-start ReseCare

Eléments du set	
	Hystéroscope 2,9mm
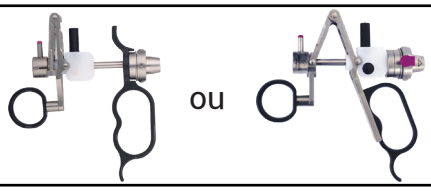	Element de travail passif ou actif
	Chemise interne 17,5Fr.
	Chemise externe 18,5Fr.
	Electrodes de résection
Autres produits nécessaires au fonctionnement	
Câble de lumière	
Caméra d'endoscopie	
Câble de résection bipolaire	
Tube d'irrigation	
Tube d'aspiration	

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel.
Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 110 A FR 2021-05.

Etape	Photo	Description
Montage		
1	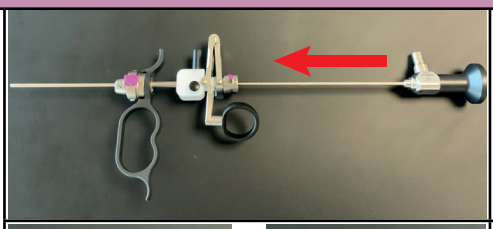	**Insérer l'hystéroscope dans l'élément de travail.**
	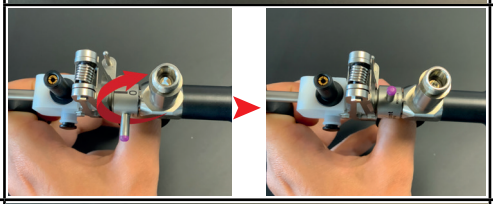	• Pour associer l'hystéroscope et l'élément de travail, le levier de verrouillage doit être tourné de sorte à ce que le «0» soit en face du connecteur du câble de lumière de l'hystéroscope. • Tourner le levier pour finaliser l'assemblage.
2	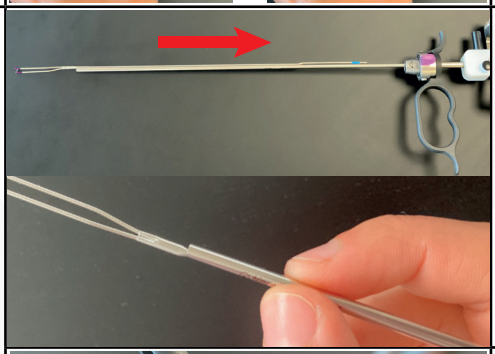	**Insérer l'électrode de résection de votre choix.** • Introduire l'hystéroscope dans le tube de l'électrode. • Faire coulisser le tube de l'électrode le long de l'hystéroscope jusqu'à l'élément de travail. ⚠ Toujours manipuler l'électrode en la tenant par le tube.
	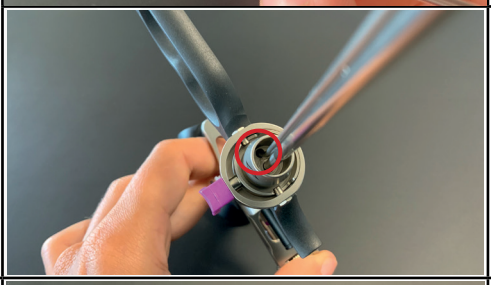	• Au niveau de l'élément de travail, l'électrode doit être insérée dans le trou dédié. Continuer de coulisser l'électrode jusqu'à ce qu'un «clic» de verrouillage se fasse entendre.
3	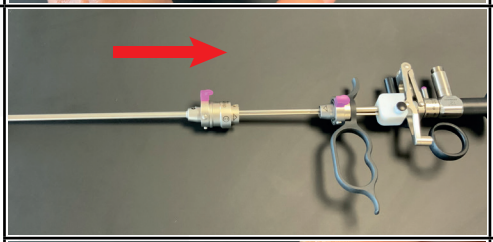	**Insérer la chemise interne.** • Introduire l'ensemble des éléments déjà assemblés dans la chemise interne.
	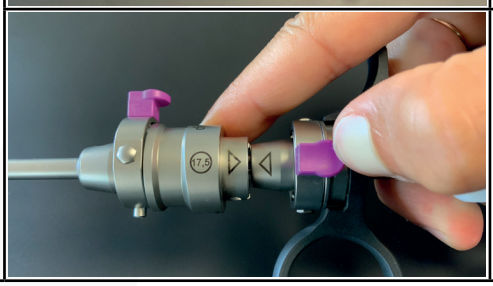	• Des flèches sont présentes sur l'élément de travail et la chemise interne. Elles doivent être alignées. • Pour finaliser l'assemblage, pousser la chemise interne dans l'élément de travail. Un «clic» de verrouillage doit se faire entendre.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel.
Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 110 A FR 2021-05.

Etape	Photo	Description
4	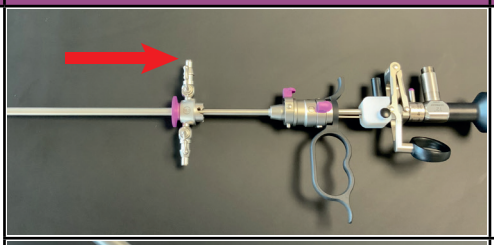	**Insérer la chemise externe.** • Introduire l'ensemble des éléments déjà assemblés dans la chemise externe.
	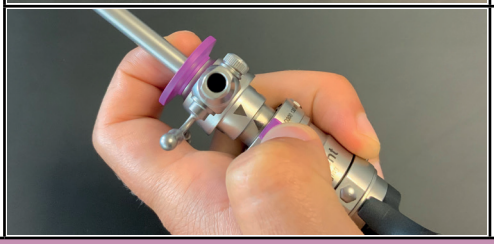	• Des flèches sont présentes sur la chemise interne et la chemise externe. Elles doivent être alignées. • Pour finaliser l'assemblage, pousser la chemise externe dans la chemise interne. Un «clic» de verrouillage doit se faire entendre.
Connexions des produits annexes à ReseCare		
1	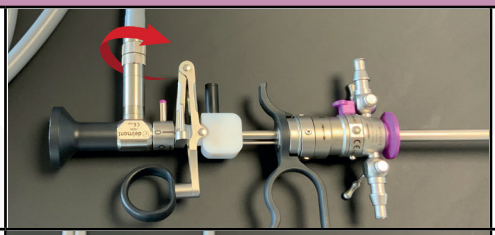	**Connecter le câble de lumière.** • Visser le câble au connecteur dédié de l'hystéroscope.
2	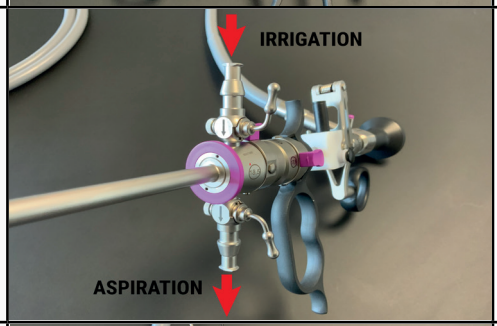	**Connecter les tubes d'irrigation et d'aspiration.** • Des flèches sont présentes sur les deux robinets pour indiquer le sens du flux. ⚠ Veiller à connecter les tubes d'irrigation et d'aspiration aux robinets correspondants.
3	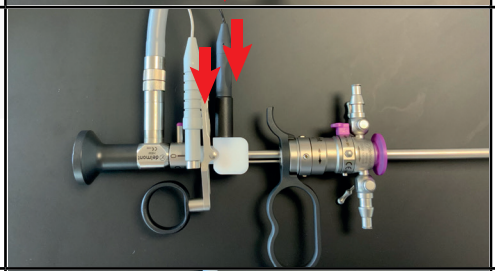	**Connecter les deux embouts du câble bipolaire.** • Les connecteurs ont un diamètre différent, prévenant toute erreur de branchement.
4	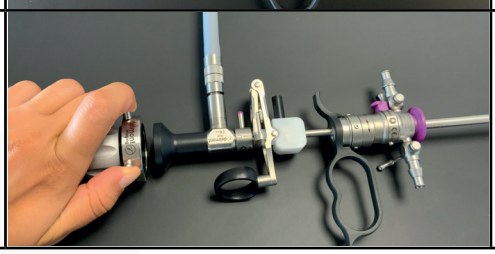	**Connecter la caméra d'endoscopie sur l'hystéroscope.**

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel.
Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 110 A FR 2021-05.

Etape	Photo	Description
Démontage		
1	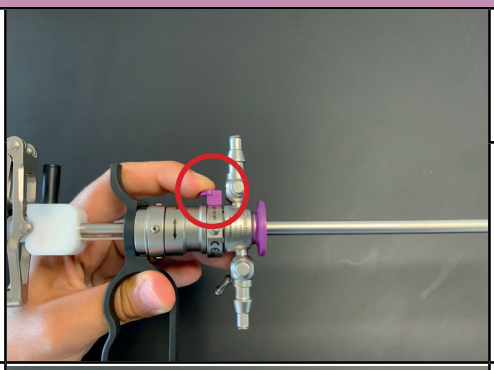	**Déconnecter les produits annexes à ReseCare.** **Retirer la chemise externe.** • Appuyer sur le bouton quick-lock afin de déverrouiller la chemise externe. ⚠ Glisser la chemise externe en la maintenant bien droite jusqu'au retrait complet, afin de ne pas endommager les produits.
2	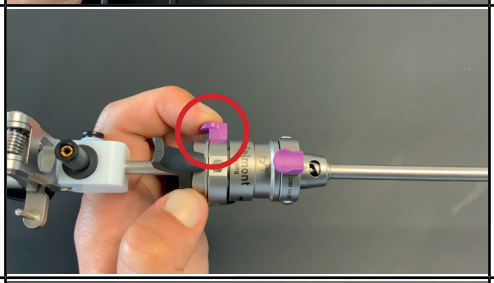	**Retirer la chemise interne.** • Appuyer sur le bouton quick-lock afin de déverrouiller la chemise interne. ⚠ Glisser la chemise externe en la maintenant bien droite jusqu'au retrait complet, afin de ne pas endommager les produits.
3	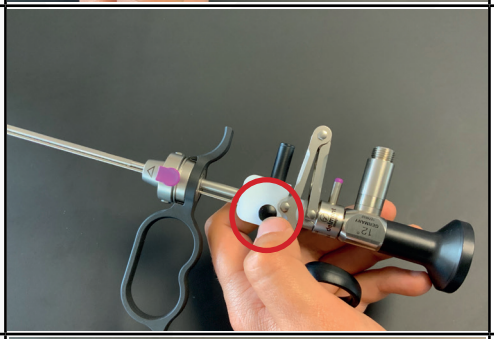	**Retirer l'electrode de résection.** • Appuyer sur le bouton poussoir noir de l'élément de travail afin de déverrouiller l'électrode. ⚠ - Essayer de retirer l'électrode sans appuyer sur le bouton poussoir va l'endommager. - L'électrode doit être retirée et manipulée en la tenant par le tube.
4	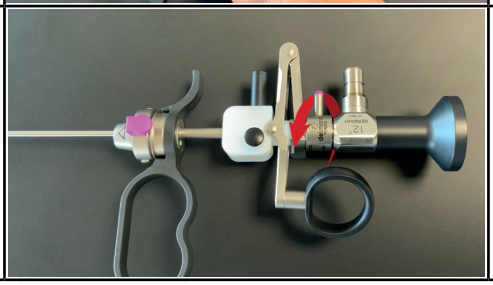	**Retirer l'hystéroscope.** • Tourner le levier de verrouillage afin de pouvoir retirer l'hystéroscope. ⚠ Glisser l'hystéroscope en le maintenant bien droit jusqu'au retrait complet, afin de ne pas endommager les produits.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel.
Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 110 A FR 2021-05.