Quick-start Mangeshikar

Eléments du set	
	Poignée avec module de rotation
	Insert avec mors Pozzi
	Chemise interne
	Chemise externe
	Chemise coulissante
	3 Coupoles (Ø 35/40/45mm)
	7 Tiges intra-utérines 4x40/5x50/6x60/7x70/8x80/8x120/8x150mm

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel.
Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 113 A FR 2021-05.

Etape	Photo	Description
Montage		
1		**Glisser l'insert avec mors Pozzi dans la chemise externe.** • Visser l'insert.
2	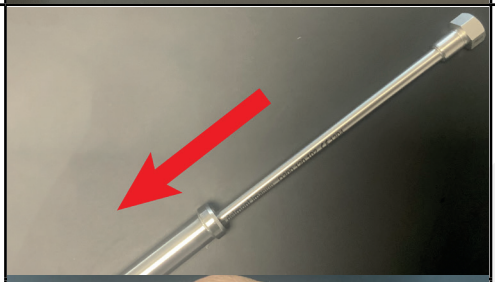	**De l'autre côté de la chemise externe, insérer la chemise interne.** ⚠ L'insert avec mors Pozzi préalablement assemblé à la chemise externe doit rentrer dans la chemise interne durant son insertion. • Pousser l'écrou de la chemise interne contre la chemise externe. Vous devez entendre un «clic» de verrouillage.
3	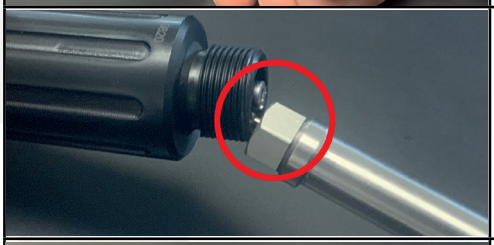 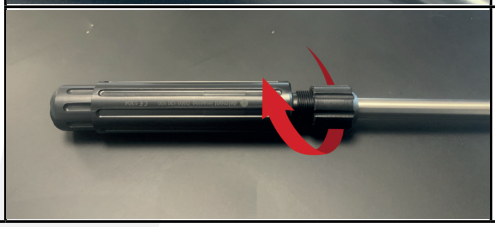	**Insérer l'ensemble sur la poignée.** • Préparer la poignée en tournant le module de rotation à sa base dans le sens horaire, pour faire sortir la vis à tête demi-fendue. Tournez jusqu'au blocage du module. • Placer la bille à l'extrémité de l'ensemble chemises/insert dans la vis à tête demi-fendue de la poignée. ⚠ S'assurer que les mors soient bien fermés pour que la bille sorte de la chemise externe. • Finaliser l'assemblage en vissant le module noir de la chemise externe à la poignée tout en maintenant la bille dans la vis à tête demi-fendue.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement. lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel.
Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 113 A FR 2021-05.

Etape	Photo	Description
4		**Assembler la chemise coulissante.** • Desserrer la vis afin de permettre son insertion sur le reste du montage et ouvrir le bouchon d'étanchéité.
	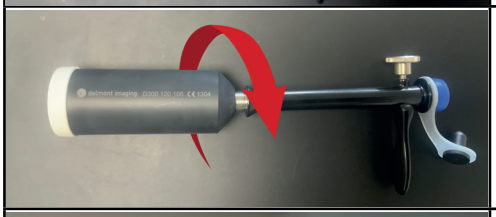	• Choisir une coupole d'un diamètre adapté à l'utérus de la patiente et la visser sur la chemise coulissante.
	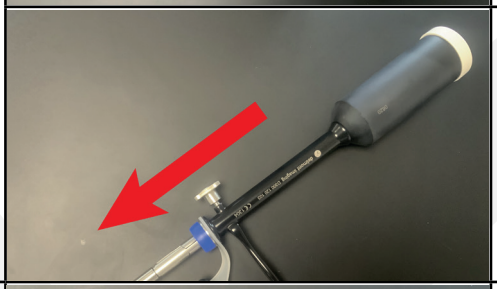	• Fermer les mors Pozzi en tournant le module de rotation de la poignée dans le sens anti-horaire et glisser la chemise coulissante sur l'ensemble chemises/ insert.
5	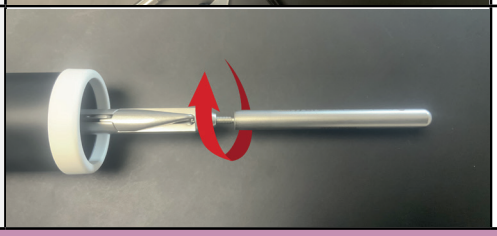	**Assembler la tige intra-utérine.** • Choisir une tige intra-utérine adaptée à l'utérus de la patiente et la visser sur l'extrémité distale de l'insert avec mors Pozzi.
Utilisation		
1		**Ouverture des mors Pozzi :** Tourner le module de rotation de la poignée dans le sens horaire. **Fermeture des mors Pozzi** : Tourner le module de rotation de la poignée dans le sens anti-horaire.
2		**Verrouillage de la position des mors Pozzi** : Enfoncer le module de rotation (en le tournant légèrement) pour le faire rentrer dans la poignée. **Déverrouillage de la position des mors Pozzi :** Appuyer sur le module de rotation (en le tournant légèrement) pour le faire sortir de la poignée.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel.
Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 113 A FR 2021-05.

Etape	Photo	Description
3		**Pendant l'opération** • Après retrait de l'utérus, refermer les mors Pozzi. • Desserrer la vis de la chemise coulissante et la retirer de l'ensemble chemises/insert.
		• Refermer le bouchon d'étanchéité de la chemise coulissante. • Repositionner la chemise coulissante dans le vagin afin de conserver l'étanchéité pendant la suture.
Démontage		
1	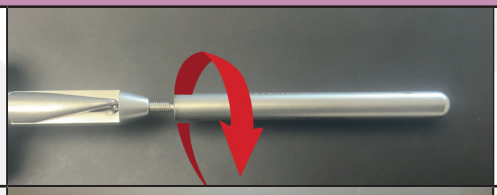	**Dévisser la tige intra-utérine.**
2	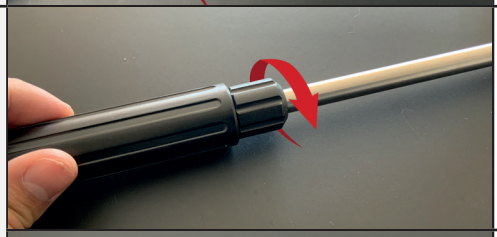	**Retirer la poignée.** • Tourner le module de rotation au maximum dans le sens horaire. • Dévisser le module de la chemise externe.
	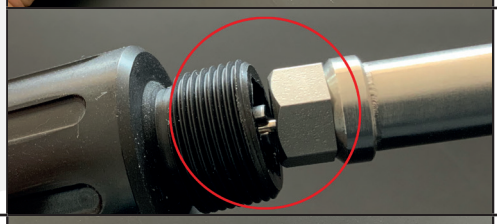	• En poussant avec le doigt, faire sortir la bille de la vis à tête demi-fendue.
3	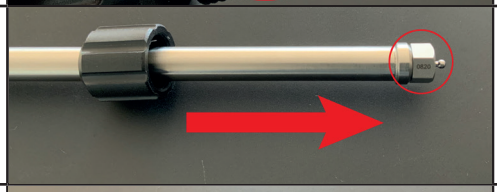	**Retirer la chemise interne.** • Tirer la chemise interne en la tenant par l'écrou.
4		**Dévisser l'insert avec mors Pozzi.**

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation. Document non contractuel.
Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.REF D900 700 113 A FR 2021-05.