delmont imaging

Mains non stériles

Mains stériles

Protocole d'utilisation de Gynko

Etape	Action par	Photo	Description
Ouverture			
1			Ouvrir l'emballage en direction de la personne aux mains stériles.
2			Sortir la chemise Gynko hors de l'emballage.
3			Enlever le tube de protection de la gaine.
Assemblage			
4		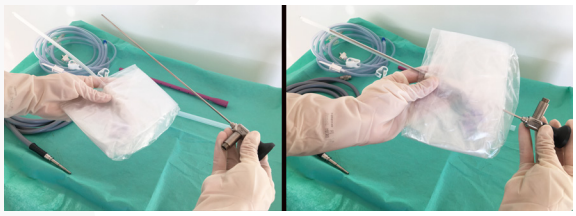	Prendre l'endoscope stérile et le glisser dans la chemise Gynko.
5		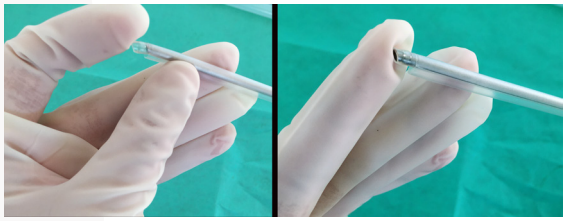	Vérifier la bonne position de l'endoscope au niveau de l'embout distal. Si besoin, appuyez **doucement** sur la lentille de la chemise Gynko pour bien l'accoler à l'endoscope.
6			Finaliser l'assemblage en vérouillant la chemise Gynko à l'endoscope. Pour cela, glisser l'endoscope jusqu'à l'encoche dans la bague de verrouillage de Gynko. Puis tourner la dite bague d'un quart de tour (90°).

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 096 A - 01/2020 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.

delmont imaging

Mains non stériles

Mains stériles

Etape	Action par	Photo	Description
Assemblage			
7			Connecter le câble de lumière à l'endoscope. Passer l'autre extrémité du câble de lumière à la personne aux mains non stérile pour connexion à la source de lumière.
8			Tendre l'oculaire de l'endoscope vers la personne aux mains non stériles.
			Associer la tête de caméra à l'endoscope.
9		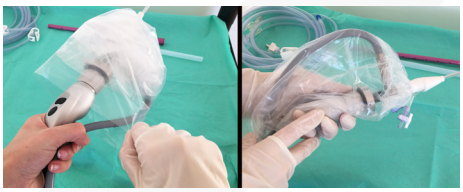	Tirer la housse stérile pour pouvoir tenir la tête de caméra.
10		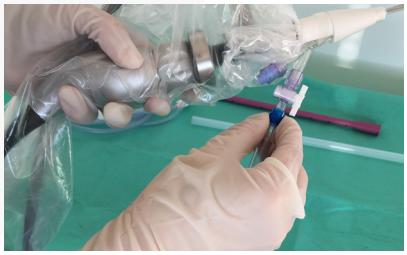	Connecter la tubulure d'irrigation au robinet correspondant et tendre les percuteurs à la personne aux mains non stériles.
Utilisation			
11		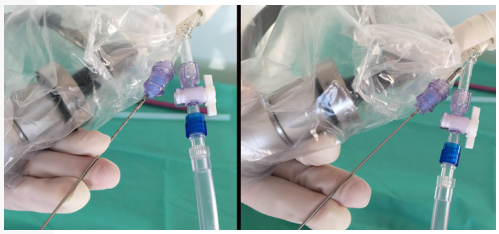	Réaliser l'hystéroscopie. Si l'utilisation d'un instrument est nécessaire, alors, insérez-le dans le bouchon anti-retour du canal opératoire en vous assurant que les mors sont bien fermés.
12		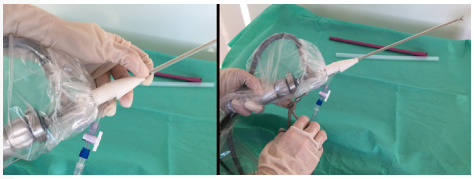	Positionner deux doigts au début du canal opérateur pour guider l'instrument lors de son passage le long du canal opératoire, jusqu'à le voir apparaître à l'écran.

delmont imaging
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Document non contractuel - Ref D900 700 096 A - 01/2020 - Copyright © 2018 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans le consentement préalable de DELMONT IMAGING.