delmont imaging

imagyn

L’hystéroscopie 2.0

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES D'IMAGYN

imagyn

Disponible dans l'App Store

L'application imagyn a été conçue pour être utilisée avec **l'iPad Pro 12,9''.**
Elle permet la gestion des hystéroscopies diagnostiques par les gynécologues obstétriciens.
Les principales fonctionnalités sont :

- La création de comptes médecins
- La création de fiches patientes
- La visualisation sur l'iPad de l'examen en streaming via Wifi
- De contrôler les actions et les paramètres de la caméra iCare de Delmont Imaging
- La réalisation d'un compte-rendu complet et de le partager (mail, impression, etc.)
- De comparer les photos de plusieurs examens d'une même patiente pour un suivi efficace
- De synchroniser l'ensemble des données sur un **Cloud médical sécurisé** et de visualiser ces données, après identification, sur n'importe quel support numérique à tout moment via www.imagyn.me

imagyn

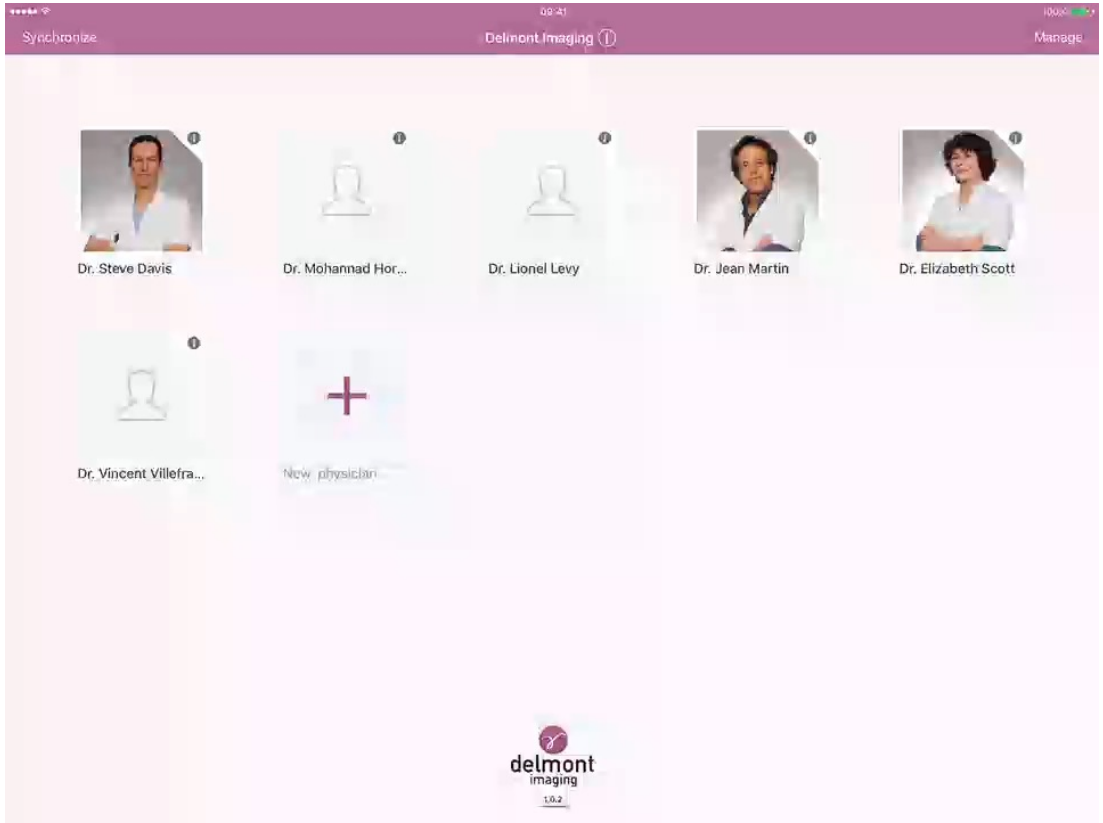
Synchronize
Delmont Imaging
Manage
Dr. Steve Davis
Dr. Mohannad Hor...
Dr. Lionel Levy
Dr. Jean Martin
Dr. Elizabeth Scott
Dr. Vincent Villefra...
New physician
delmont
imaging
1.0.2

LES FONCTIONNALITÉS PARTICULIÈRES D'IMAGYN

La création de comptes médecin

La création d'un compte médecin nécessite **d'être connecté à internet** durant le processus.

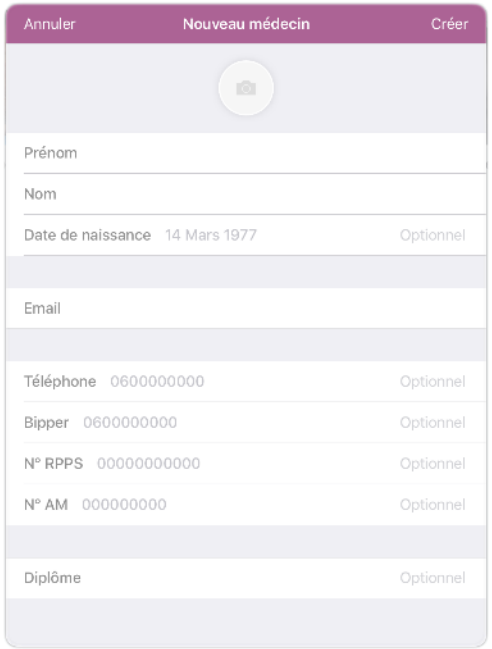

Les champs obligatoires sont : le nom, le prénom et l'email.

Lors de la création, il devra ensuite définir son code personnel à 6 chiffres. Il permet de **sécuriser** son compte.
A chaque connexion et mise en veille de l'iPad, le médecin devra rentrer ce code.

En cas d'oubli, il reçoit par mail un lien pour changer son code à 6 chiffres.

La recherche de patientes

Un médecin peut effectuer une recherche spécifique de patiente grâce à la barre de recherche.

Tous les champs de la fiche patiente peuvent être utilisés pour trouver une patiente.
(Nom, prénom, date de naissance, n° de sécurité sociale, …)

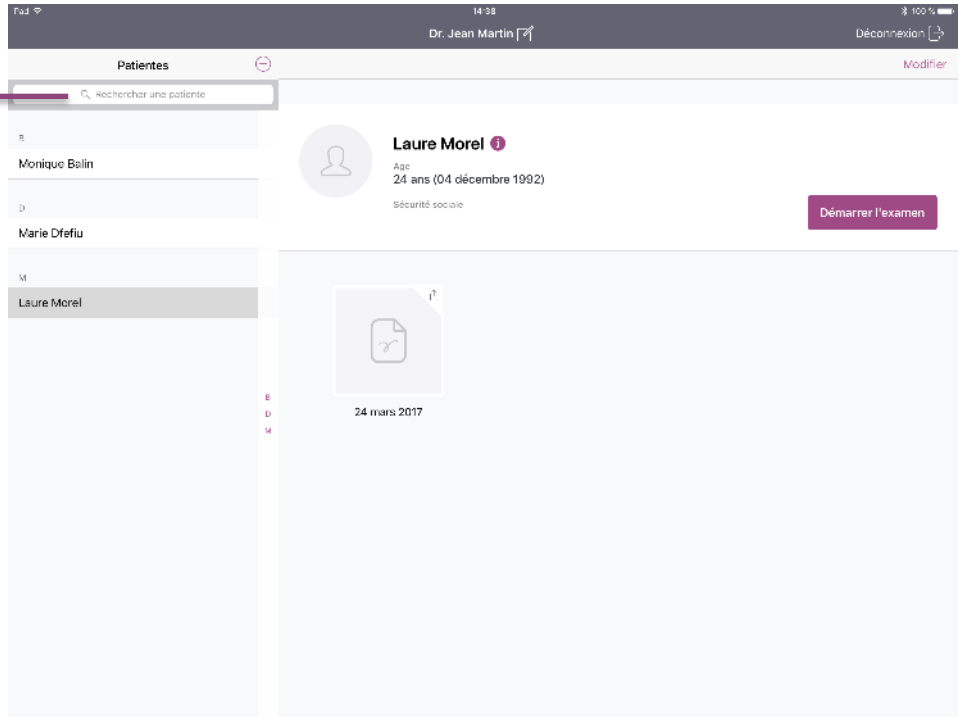

On peut également faire la recherche de patientes par **pathologies** via la même barre de recherche.
Cela est permis grâce au champ pathologies présent dans les comptes rendus.

La modification d’un compte-rendu

Un compte rendu reste partiellement modifiable : seuls les champs peuvent être mis à jour ultérieurement.
Les photos et les schémas anatomiques ne peuvent plus être modifiés.
La modification des champs se fait ici :

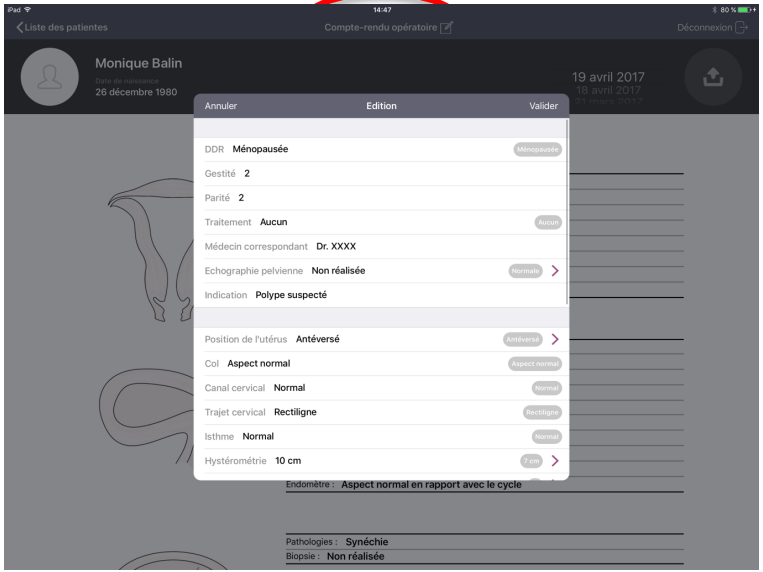

Le démarrage rapide

Cette fonctionnalité permet de lancer un nouvel examen sur l'iPad, d'avoir l'image de la caméra en streaming mais sans vouloir faire un compte-rendu par la suite.
Le démarrage rapide est accessible au même écran que celui des comptes médecins :

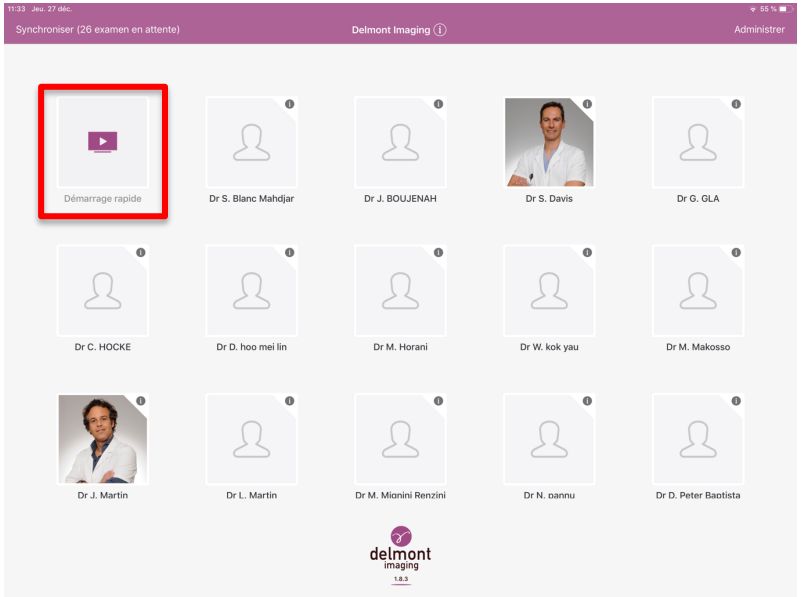

Aucune donnée ne sera donc conservée sur l'iPad après cet examen (pas même les photos).
Photos et vidéos restent accessibles sur la clé USB d'iCare.

La gestion de l'espace de stockage

Initialement, un centre de soins possède un espace de stockage de **5Go** sur le Cloud. Ces 5Go sont gratuits la première année.
Un suivi de consommation de cet espace peut se faire en cliquant ici :

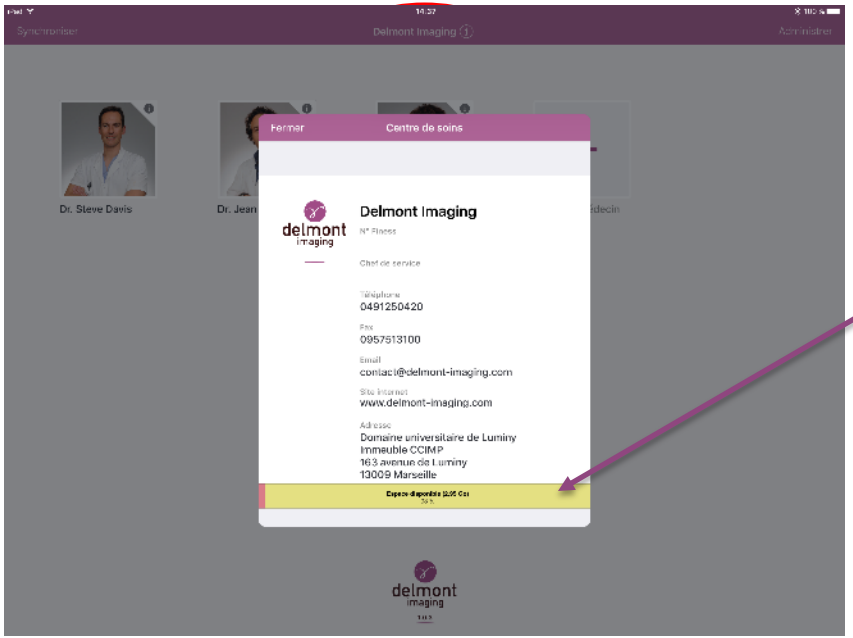

On visualise l'espace restant et l'espace consommé.
Si l'espace est plein, la synchronisation sur le Cloud est bloqué jusqu'à que le centre de soins commande un espace Cloud supplémentaire.

L’administrateur

L’administrateur est une personne désignée dans le centre de soins. Cette personne possède un identifiant et un mot de passe personnel qui lui permet d’accéder à des fonctions supplémentaires :

- L’accès au panneau de configuration Wifi d’iCare
- De masquer / afficher un médecin
- De supprimer un médecin
- De supprimer une patiente
- De transférer une patiente à un autre médecin du centre de soins
- De supprimer un examen

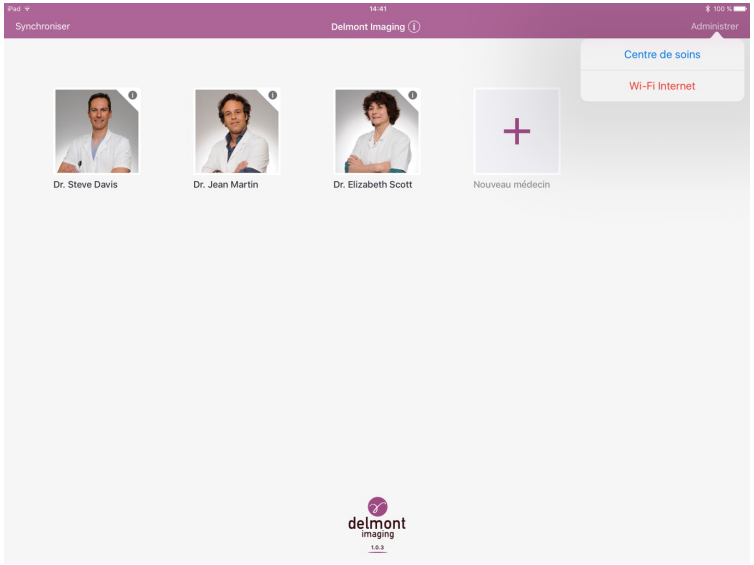

<u>Note</u>: une synchronisation s’effectue automatiquement et obligatoirement avant de pouvoir accéder à ces fonctionnalités

L’APPLICATION WEB
WWW.IMAGYN.ME

Les fonctionnalités

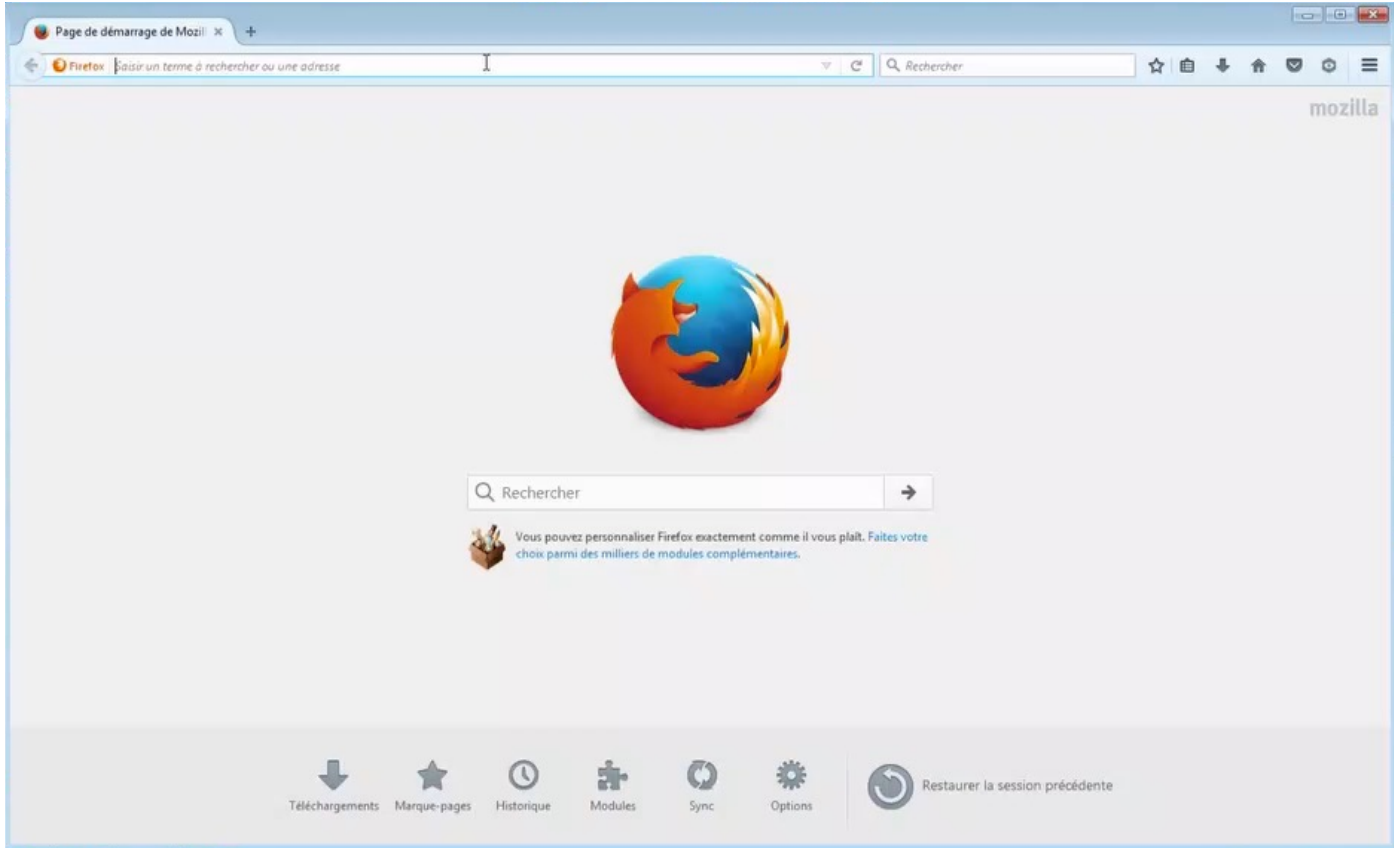

Disponible sur tous les supports

S'agissant d'une application web, un médecin peut consulter ses informations sur tous les supports numériques (ordinateur, tablette, téléphone, …) et tous les systèmes d'exploitation (iOS, android, etc.)

Il lui suffit de s'identifier avec son adresse mail et son mot de passe *(celui reçu par mail à la création de son compte médecin sur imagyn (app iPad))*.
En cas d'oubli ou s'il souhaite changer son mot de passe :

Il recevra un lien par mail où il peut définir un nouveau mot de passe.
Seul critère : 6 caractères minimum

LA GESTION DES RÉSEAUX WIFI

Le fonctionnement général

Wifi iCare

1. Connexion de l'iPad au **Wifi d'iCare**
(cela permet de voir les examens en streaming)

2. Connexion d'iCare au **Wifi internet du centre de soins**

Wifi internet du centre de soins

3. L'iPad reçoit la connexion internet du centre de soins **via iCare**

La gestion du Wifi iCare

Pour pouvoir visualiser l'examen en streaming, l'iPad doit donc être connecté au réseau Wifi d'iCare. Le nom du Wifi sera toujours : **iCare-WXYZ** (avec WXYZ les 4 chiffres du numéro de série d'iCare) et le mot de passe : **Delmont-ZYXW** (avec ZYXW les 4 chiffres du numéro de série en ordre inverse).

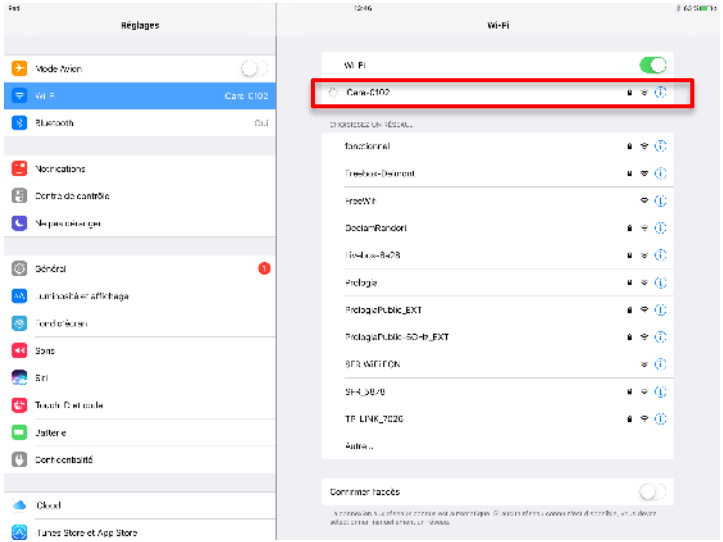

Si l'examen est lancé sans être connecté au wifi iCare, un message d'alerte est présent et un bouton redirige dans les réglages Wifi.

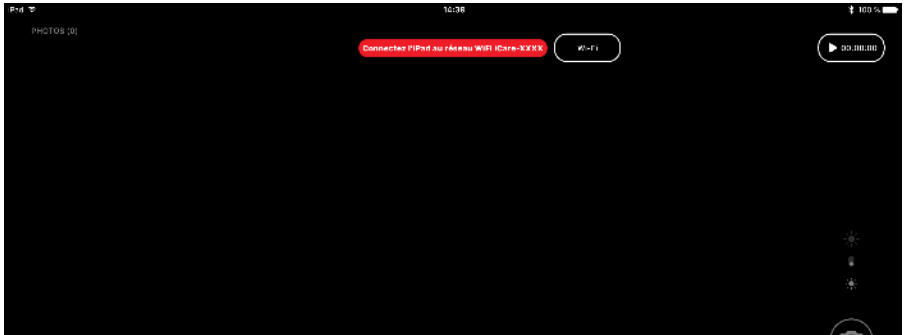

La gestion du Wifi internet

Pour connecter iCare au Wifi internet du centre de soins, **l'administrateur** doit :

Entrer le mot de passe de l'administrateur

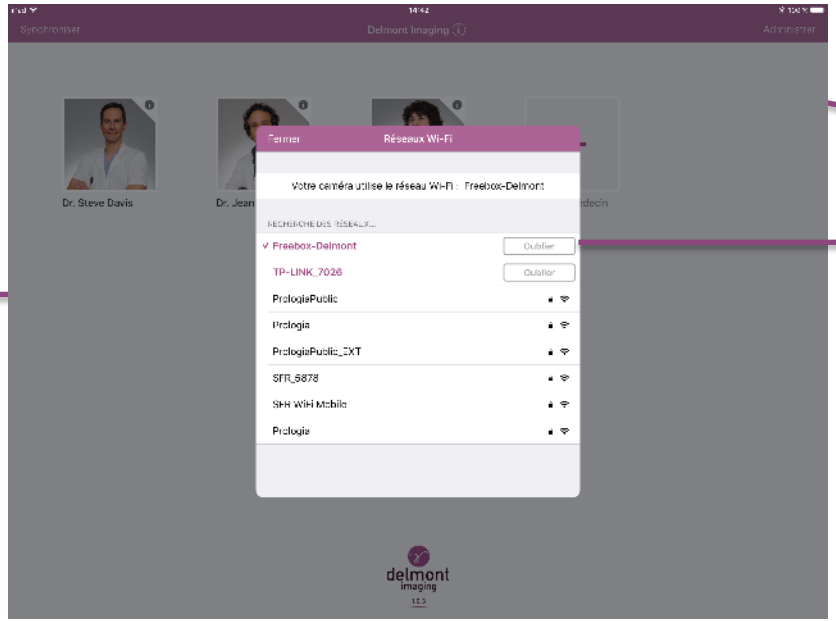

Cliquer sur : Administrer > Wi-Fi internet

Choisir le Wifi du centre de soins et rentrer leur mot de passe.

DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES

Diagnostic des problèmes

- ***Je n'arrive pas à visualiser le flux de la caméra en streaming sur mon iPad (et le flux est présent sur le moniteur).***

Si le message d'alerte en haut de l'écran est :

Dans ce cas allez dans les paramètres de l'iPad et connectez vous au réseau Wifi d'iCare.

Si le message d'alerte est : « Impossible d'obtenir la vidéo ».
Essayer d'abandonner l'examen en cours et reconnectez vous. Si le flux n'apparaît toujours pas, éteignez la caméra et rallumez la. Après reconnexion au Wifi iCare, si cela ne fonctionne toujours pas, contactez le SAV de Delmont Imaging.

- ***Je n'arrive pas à créer un nouveau compte médecin***.

Vous n'avez pas de connexion internet.

Diagnostic des problèmes

- ***Le stylet ne marche pas / plus***.

Vérifiez que l'iPad a le Bluetooth d'activé. Sinon activez le.
Si ça ne marche toujours pas, branchez le stylet sur votre iPad. Si un pop-up de jumelage apparaît, jumelez votre stylet à votre iPad. Débranchez le stylet.
Si aucun pop-up n'apparaît, vérifiez l'état de la batterie de votre stylet dans le centre de notifications de l'iPad (balayer à gauche sur l'écran principal).

- ***La synchronisation des examens ne marche pas.***

Vérifiez si l'espace de stockage alloué au centre de soins n'est pas plein. Dans ce cas là, contactez votre représentant commercial.
Si l'espace de stockage n'est pas plein, vous n'avez pas de connexion internet.

- ***Sur imagyn.me je n'ai pas accès à toutes mes data.***

Il faut lancer une synchronisation d'imagyn sur l'iPad.

Diagnostic des problèmes

- ***L'envoi de mail ne marche pas***.

Vous n'avez pas de connexion internet.

- ***Je ne vois pas mon imprimante pour lancer l'impression de mon compte rendu.***

Si l'imprimante ne possède pas la fonction AirPrint, l'impression ne marchera pas depuis l'iPad. Dans ce cas plusieurs solutions comme par exemple :

- Envoyez par mail le compte rendu et imprimez depuis un autre poste.
- Synchroniser imagyn puis allez sur imagyn.me et imprimer depuis imagyn.me.

Si votre imprimante possède la fonction AirPrint, dans ce cas, l'iPad n'est pas connecté au bon réseau Wifi. Connectez vous sur le Wifi d'iCare ou sur le réseau sur lequel est branché votre imprimante.

Diagnostic des problèmes

- ***Je ne vois plus le Wifi d'iCare dans les paramètres de l'iPad***

La voie de commande iCare est elle toujours allumée ? Sinon rallumez la.
Si elle est allumée, vérifiez qu'au moins une des clés Wifi à l'arrière d'iCare clignote (LED bleue). Si aucune clignote, les 2 clés Wifi sont cassées. Il faut alors les remplacer.
Si elles clignotent, contactez le SAV de Delmont Imaging

- ***Je n'arrive pas à prendre des photos ou des vidéos (les autres commandes tel que l'AWB fonctionne et le flux vidéo est présent)***

Vérifiez qu'une clé USB de stockage de masse est présente à l'arrière de la voie de commande iCare.
Vérifiez qu'elle est bien connectée.
S'il s'agit d'une clé USB différente que celle fourni par Delmont imaging à la livraison, il est possible que votre clé USB ne soit pas reconnu.

- ***Je n'ai pas reçu l'email à la création de mon espace médecin / je ne reçois pas les emails de régénération des mots de passe***

Vérifiez dans les spams de votre boite mail.